


PRO-AQUAN PAINEHUUHTELULAITTEEN IMULETKUN VESIPISTOKKEEN UROSOSAN KIINNITYKSEN OHJEISTUS

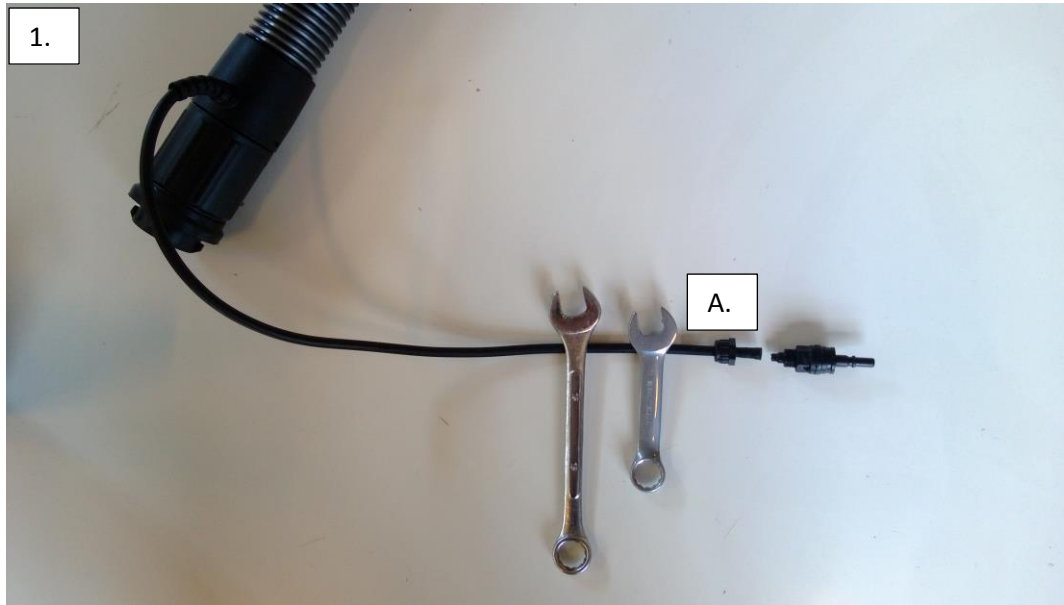

OHJEET:

1. Aseta mutteripää (A.) ensin letkuun
2. Työnnä letku urososan kantaan asti ja kiinnitä mutteripää lukitsemaan letku urososaan. Kiinnitä mutteri ja urososa kevyeen tiukkuuteen 15" jakoavaimilla.